

FICHA TÉCNICA - Barandilla Segmentada Acero



Nuestras barandillas son fáciles de usar y seguras, ya que su sistema de fijación se desliza al abatirlas, y el exclusivo diseño de seguridad evita accidentes y pinzamientos.

**Por motivos de mejora de nuestros productos, Tecnimoem Care se reserva el derecho de cambiar especificaciones técnicas y/o imágenes de nuestros productos sin previo aviso.*

Barandilla Segmentada Acero

FICHA TÉCNICA

Barandilla Segmentada de Acero

Para nuestras camas, el amarre está preparado para el bastidor de 50x20mm.

(Habitual en las camas de Tecnimoem).

ESPECIFICACIONES TECNICAS


PESO JUEGO	22,8 KG.
Estructura Acero	
*Opción Madera	
Recubrimiento Pintura Epoxi-Poliéster.	
Sistema de bloqueo automático en su posición elevada	

INFORMACION DE ADAPTACIÓN A NORMA DE CAMAS MEDICAS EN 60601-2-52

TECNIMOEM CARE, recomienda colocar las barandillas partidas de la siguiente forma para cumplir con los requisitos establecidos en la norma EN-60601-2-52.

En el montaje deben respetarse las siguientes medidas de seguridad:

- distancia entre la barandilla y la cara interna del cabecero: menor de 60mm.
- distancia entre la barandilla y la cara interna del piecero: menor de 60mm. o mayor de 318mm.
- distancia entre cara superior del colchón y parte superior de la barandilla: mayor o igual a 220mm.
- huecos entre barras, o entre la barra inferior y la base del colchón: menor de 120mm.
- distancia entre barandillas segmentadas elevadas: menor de 60mm o mayor de 318mm.
- longitud de barandilla: superior al 50% de la longitud del somier

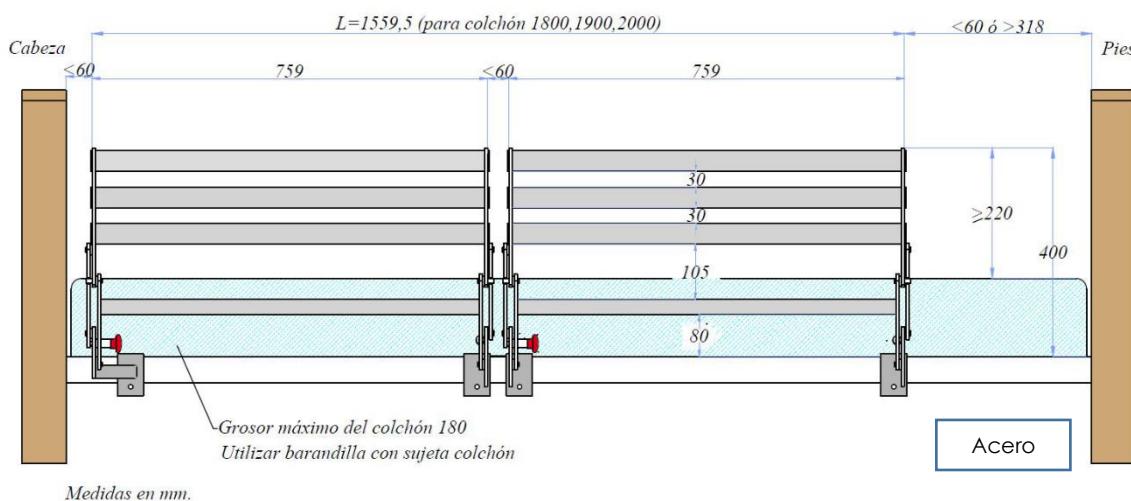

*Para nuestro modelo de cama de Columna Baja (Teide/Aneto), se recomienda elevar y descender la cama, **SIEMPRE**, con las barandillas en posición elevada.



Para evitar posibles caídas de los usuarios y/o atrapamientos en los pies.

INFORMACIÓN DE MONTAJE

Cada parte de la barandilla es distinta y vienen identificadas con una pegatina para facilitar su colocación. La referencia siempre es, Paciente tumbado en la cama y tirador rojo en la cabecera.

Tenemos:

- CABECERA DERECHA, PIECERA DERECHA (Barandilla derecha)
- CABECERA IZQUIERDA, PIECERA IZQUIERDA (Barandilla izquierda)

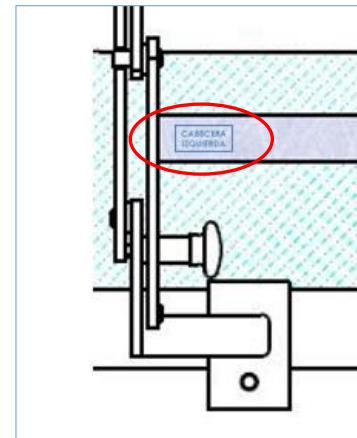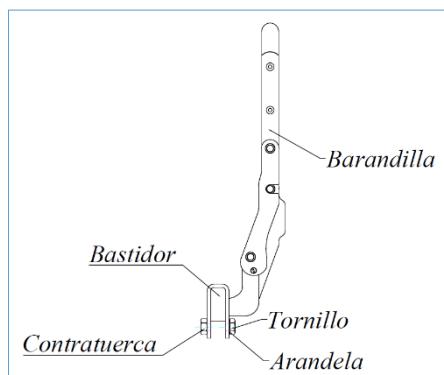

Colocar los amarres en forma de "U" en los laterales de la cama, en el bastidor.


Pasar el tornillo hexagonal (entre bastidor y tornillo, colocar la arandela) por los agujeros de los amarres, con la cabeza hacia el exterior de la cama.

Poner la contratuerca y apretar con llave fija de 17.



Ajustar la barandilla con el tope (tornillo plástico blanco) para evitar que la barandilla se venga hacia afuera.

**De fábrica viene ajustado, pero puede ser necesario ajustarlo más, una vez colocada.*



Para plegar la barandilla, se aconseja empujarla suavemente hacia el interior de la cama y después tirar del tirador rojo para plegarla.

"Colchones y/o barandillas incompatibles pueden crear riesgos"